WINALITE

「ララムーンシリーズ商品」
案内資料

ウィナライト・インターナショナル

WINALITE

LaLa Moon ララ*ムーン

「軽くて、薄い」

抜群のフィット感を実現しました

WINALITE

“世界のサニタリー製品”
を製造するインターナショナル自社工場

WINALITE

“世界のサニタリー製品”
を製造するインターナショナル自社工場

・欧州市場における
“医用機器CEマーキング取得”
サニタリー製品の製造

・ISO9001取得

・米国FDA認証取得

WINALITE

ララムーンシリーズ商品の特徴

- トルマリンパワーを最大限活用する特殊コーティング（自社特許技術）
- 安心・安全で、素早く体感できる高品質
- 世界80ヶ国以上での販売実績

WINALITE

ララムーン特許技術概要

(WIPO,世界知的所有権機関;PCT.特許協力条約)
2005-12　WO2005118010A1　WIPO・(PCT)
2004-06　CN200420064658.0　CHINA

Description
マイナスイオンセンターテープを含む生理用ナプキンまたはパッドの開発

開発の目的・概要

開発の目的は、生理用ナプキンまたはパッドを使用中、人体によって加熱および湿らせることにより、殺菌効果、抗炎症効果、および正確な効果を持つ部品を提供することです。

トルマリンパウダー＆ナノセラミックパウダー配合センターテープ

トルマリンパウダーとは、温度および湿度の条件下で、マイナスイオンを自動的に放出できるアクティブな宝石を含むトルマリンのことです。最大100万電子ボルトの電位差が生じる可能性があります。これにより、空気がイオン化され、ヒット電子が隣接する酸素分子と水分子に付着し、負の空気イオン、つまり負の水素イオンH302と負の酸素イオンに変換されます。抗菌・婦人科疾患予防につながります。

ナノセラミックパウダーは、波長4～14ミクロンの遠赤外線を放出します。放射率が85%を超える遠赤外線は皮下組織を透過し代謝を促進、免疫力を高めます。これをパッドに使用することにより、膣周囲の微小循環を促進し、生物学的酵素や膣内の酸性分泌物を増やし、PH値を調整し、女性の自己保護能力を改善します。

WINALITE

ISO9001取得

CERTIFICATE

Quality Management Systems Certificate

Certificate Number: 00215Q14232R1M

CQM hereby certifies that

GuangDong For You Essentials Manufacturing Co.,Ltd.

has implemented and maintains a Quality Management System which fulfils the requirements of the following standards

GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008

Quality management systems---Requirements

This certificate is valid to the following product(s)/service:

The manufacture of sanitary napkin and pantliner

Issued on: 2015-07-27

Effective date: 2015-07-27

Validity Date: 2018-07-26

Registration Number: CQM-44-2012-0085-0001

Zhang Wei
CEO of CQM

CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP

ISO9001：製品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とした品質マネジメントシステム規格。外部の第三者機関から証明（認証）を得ることで、組織内外に対する説明責任を果たすことができ、社会的信頼を得ることができます。

米国FDA認証取得

Fiscal Year 2020

CERTIFICATION OF REGISTRATION

This certifies that:

GUANGDONG FOR YOU ESSENTIALS MANUFACTURING CO.,LTD

NO.6,SHANHUA ROAD,YANGHE TOWM,GAOMING DISTRICT
FOSHAN, Guangdong, 528500, CHINA

has completed the FDA Establishment Registration and Device Listing with the US Food & Drug Administration, through

HEALREG SERVICE INC

Owner/Operator Number: 10060785

Device Listing#: See annex

Other Business Trade Name(s): WINION、LALAMOON、QIRAY、LOVEMOON、Winalite、V-shine

HEALREG SERVICE INC will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until the end of the calendar year stated above, unless said registration is terminated after issuance of this certificate. HEALREG SERVICE INC makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any representations or warranties to any person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. This certificate does not denote endorsement or approval of the certificate-holder's device or establishment by the U.S. Food and Drug Administration. HEALREG SERVICE INC assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing.

Pursuant to 21 CFR 807.39, "Registration of a device establishment or a assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding." The U.S. Food and Drug Administration does not issue a certificate of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration, HEALREG SERVICE INC is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.

FDA

Chief engineer
Issued: March 18, 2020
Expiration Date: December 31, 2020

米国FDA：アメリカ食品医薬品局。米国で販売される食品、医薬品医療機器等の安全性と有効性についての保証認定や取締りなどを行う専門機関です。

CEマーク取得

EPORT

Declaration of Conformity

Order No.: EPTC-WA-S1012592

Issue date: January 5, 2011

In accordance with the following applicable directives:

The Cosmetic Directive 76/768/EEC

The device, as described herewith, was tested pursuant to applicable test procedure and complies with the requirements of:

EN ISO 11137-2: 2006
EN ISO 11137-3: 2006

Applicant:	THE HONG KONG WINALITE GROUP LIMITED ROOM 1204-1206, 12/F, WAI FUNG PLAZA, 664 NATHAN ROAD, MONGKOK, HONG KONG
Product:	LOVE MOON ANION SANITARY NAPKIN(DAY, OVERNIGHT, PANTY LINER)
Model number:	WF-28S

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant directives have to be observed.

CE

Authorized by: Eliza Chen

COMMON SEAL

Eport Compliance Laboratory Limited

Http://www.eportsz.com

CEマーク：製品をEU加盟国へ輸出する際に、使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件（安全基準条件）を満たすことを証明するマークです。

WINALITE

検査機関による試験データ（完成品）

SGS（ Société Générale de Surveillance）

・転移性蛍光増白剤の未検出

・塩素含有量≒「0.0%」

（検査結果0.012%） 1mg/kg=0.0001%

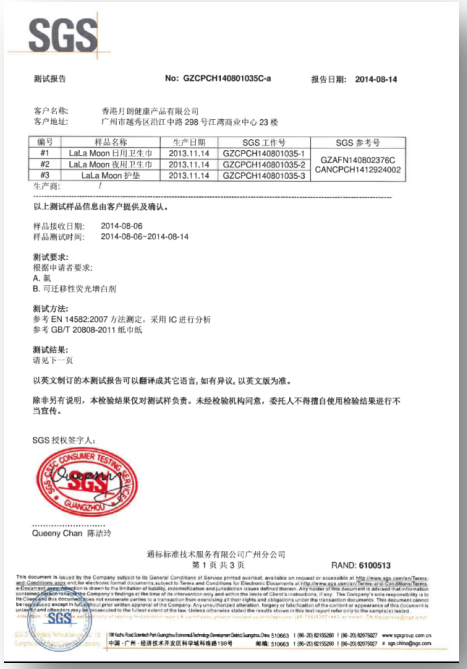

SGS

测试报告 No: GZCPCH140801035C-a 报告日期: 2014-08-14

客户名称: 香港月朗健康产品有限公司
客户地址: 广州市越秀区沿江中路 298 号江湾商业中心 23 楼

编号	样品名称	生产日期	SGS 工作号	SGS 参考号
#1	LaLa Moon 日用卫生巾	2013.11.14	GZCPCH140801035-1	GZAFN140802376C CANCPCH1412924002
#2	LaLa Moon 夜用卫生巾	2013.11.14	GZCPCH140801035-2	
#3	LaLa Moon 护垫	2013.11.14	GZCPCH140801035-3	

生产商: /

以上测试样品信息由客户提供及确认。

样品接收日期: 2014-08-06
样品测试时间: 2014-08-06~2014-08-14

测试要求:
根据申请者要求:
A. 氯
B. 可迁移性荧光增白剂

测试方法:
参考 EN 14582:2007 方法测定，采用 IC 进行分析
参考 GB/T 20808-2011 纸巾纸

测试结果:
请见下一页

以英文制订的本测试报告可以翻译成其它语言，如有异议，以英文版为准。

除非另有说明，本检验结果仅对测试样负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

SGS 授权签字人:

Queeny Chan 陈洁玲

通标标准技术服务有限公司广州分公司
第 1 页 共 3 页 RAND: 6100513

SGS

测试报告 No: GZCPCH140801035C-a 报告日期: 2014-08-14

测试结果:
A.

测试项目	单位	测试方法（参考）	测试结果 #1	方法检出限
氯(Cl)	mg/kg	EN 14582:2007 方法测定，采用 IC 进行分析	120	50

测试项目	单位	测试方法（参考）	测试结果 #2	方法检出限
氯(Cl)	mg/kg	EN 14582:2007 方法测定，采用 IC 进行分析	131	50

测试项目	单位	测试方法（参考）	测试结果 #3	方法检出限
氯(Cl)	mg/kg	EN 14582:2007 方法测定，采用 IC 进行分析	119	50

备注：1mg/kg = 0.0001%.

B:

测试项目		单位	测试方法(参考)	测试结果 #1
可迁移性荧光增白剂	254nm	/	GB/T 20808-2011	无可迁移性荧光增白剂
	365nm	/		无可迁移性荧光增白剂

测试项目		单位	测试方法(参考)	测试结果 #2
可迁移性荧光增白剂	254nm	/	GB/T 20808-2011	无可迁移性荧光增白剂
	365nm	/		无可迁移性荧光增白剂

测试项目		单位	测试方法(参考)	测试结果 #3
可迁移性荧光增白剂	254nm	/	GB/T 20808-2011	无可迁移性荧光增白剂
	365nm	/		无可迁移性荧光增白剂

通标标准技术服务有限公司广州分公司
第 2 页 共 3 页 RAND: 6100513

SGS

测试报告 No: GZCPCH140801035C-a 报告日期: 2014-08-14

样品描述: 片状样品

附图

#1

#2

#3

报告结束

通标标准技术服务有限公司广州分公司
第 3 页 共 3 页 RAND: 6100513

SGS：検査・検証・試験および認証業界において世界的なトップ企業。現在、世界2,400カ所以上のオフィスおよび研究所にて活動。

塩素含有量：一般的に殺菌などの目的で使用される漂白剤などの残留の目安になります。弊社こだわりの加工技術で、**「ほぼゼロ」**を達成しております。一般のメーカーでは、データを開示していません。

WINALITE

検査機関による試験データ（完成品）

国家紙質監督検査センター

・各種菌類の未検出　　・PH値7.3（中性）

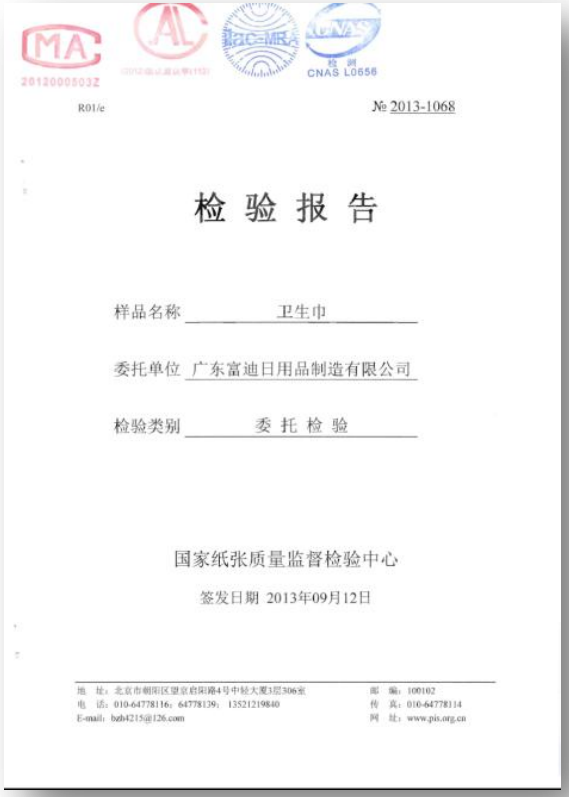

R01/e　　№ 2013-1068

検 验 报 告

样品名称　卫生巾

委托单位　广东富迪日用品制造有限公司

检验类别　委 托 检 验

国家纸张质量监督检验中心

签发日期 2013年09月12日

地　址：北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦3层306室　　邮　编：100102
电　话：010-64778116；64778139；13521219840　　传　真：010-64778114
E-mail：bzb4215@126.com　　网　址：www.pix.org.cn

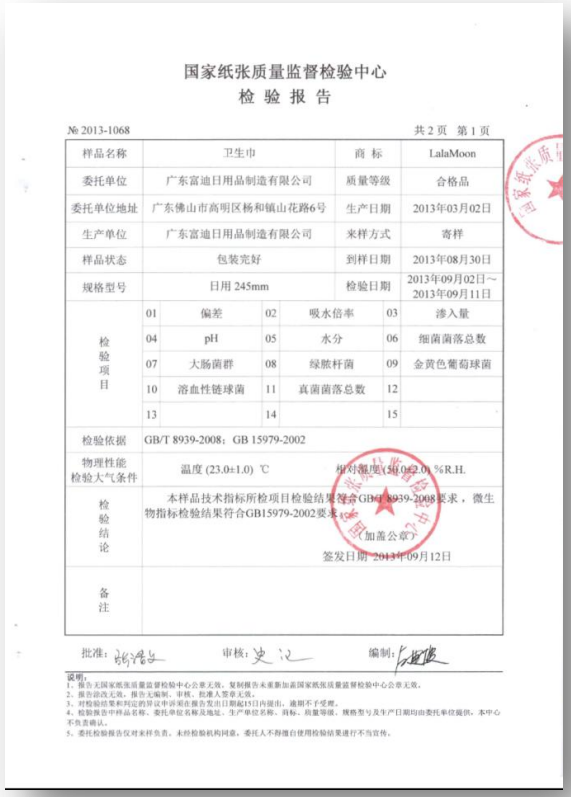

国家纸张质量监督检验中心
检 验 报 告

№ 2013-1068　　共 2 页　第 1 页

样品名称	卫生巾		商 标	LalaMoon	
委托单位	广东富迪日用品制造有限公司		质量等级	合格品	
委托单位地址	广东佛山市高明区杨和镇山花路6号		生产日期	2013年03月02日	
生产单位	广东富迪日用品制造有限公司		来样方式	寄样	
样品状态	包装完好		到样日期	2013年08月30日	
规格型号	日用 245mm		检验日期	2013年09月02日～2013年09月11日	
检验项目	01 偏差	02 吸水倍率	03 渗入量		
	04 pH	05 水分	06 细菌菌落总数		
	07 大肠菌群	08 绿脓杆菌	09 金黄色葡萄球菌		
	10 溶血性链球菌	11 真菌菌落总数	12		
	13	14	15		
检验依据	GB/T 8939-2008；GB 15979-2002				
物理性能检验大气条件	温度 (23.0±1.0) ℃	相对湿度(50.0±2.0) %R.H.			
检验结论	本样品技术指标所检项目检验结果符合GB/T 8939-2008要求，微生物指标检验结果符合GB15979-2002要求。（加盖公章） 签发日期 2013年09月12日				
备注					

批准：　审核：　编制：

说明：
1. 报告无国家纸张质量监督检验中心公章无效，复制报告未重新加盖国家纸张质量监督检验中心公章无效。
2. 报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
3. 对检验结果和判定的异议申诉须在报告发出日期起15日内提出，逾期不予受理。
4. 检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本中心不负责确认。
5. 委托检验报告仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

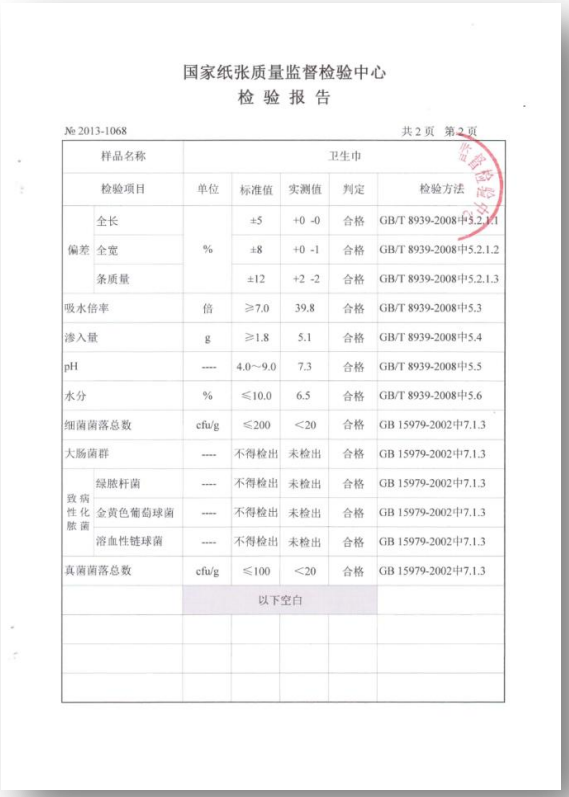

国家纸张质量监督检验中心
检 验 报 告

№ 2013-1068　　共 2 页　第 2 页

样品名称		卫生巾				
检验项目		单位	标准值	实测值	判定	检验方法
偏差	全长	%	±5	+0 -0	合格	GB/T 8939-2008中5.2.1.1
	全宽		±8	+0 -1	合格	GB/T 8939-2008中5.2.1.2
	条质量		±12	+2 -2	合格	GB/T 8939-2008中5.2.1.3
吸水倍率		倍	≥7.0	39.8	合格	GB/T 8939-2008中5.3
渗入量		g	≥1.8	5.1	合格	GB/T 8939-2008中5.4
pH		----	4.0～9.0	7.3	合格	GB/T 8939-2008中5.5
水分		%	≤10.0	6.5	合格	GB/T 8939-2008中5.6
细菌菌落总数		cfu/g	≤200	<20	合格	GB 15979-2002中7.1.3
大肠菌群		----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002中7.1.3
致病性化脓菌	绿脓杆菌	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002中7.1.3
	金黄色葡萄球菌	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002中7.1.3
	溶血性链球菌	----	不得检出	未检出	合格	GB 15979-2002中7.1.3
真菌菌落总数		cfu/g	≤100	<20	合格	GB 15979-2002中7.1.3
以下空白						

WINALITE

ララムーンのこだわり品質

- ポリプロピレン不織布：（ビューティーパッド表面層に使用）
  繊維の中で最も比重が軽く、吸湿性・吸水性がほとんどない。独自のDrilling構造で、ソフトな感触と究極のさらさら感を実現。

- PET不織布:（トルマリン＆ナノセラミック配合センターテープに使用）
  耐熱性・耐水性に優れ、寝具用・衣料用等の中素材にも使用される。

- ポリオレフィン系不織布:（超吸収シートに使用）
  紙おむつなどにも使われ、「柔らかな肌触り」が特長。

- 綿状パルプ:（超吸収シートに使用）
  アメリカ・カナダ製の高級バージンパルプを使用。不織布・吸水紙よりも吸水率が高い。

- 高分子吸収材:
  大手日本メーカー製の高品質の高分子吸収材を使用。

- ポリエチレンフィルム:（防水層に使用）
  吸水性がほとんど無いため防水性が高い。高い通気性を確保。

各素材メーカーへ素材の安全性を確認し、弊社工場にて製品化しております。

LINE@からのお問合せもマンツーマンにて対応いたします！

LINE ID：@winalite.jp

友だち追加

株式会社ウィナライトジャパン
TEL：03-3980-9666

WINALITE

私たちの使命

ウィナライト・インターナショナルは、
「ライフスタイルのイノベーション」に貢献し、全世界のご愛用者様へ、更なる喜びと感動を提供し続けます。

：弊社商品を取り扱っている世界の拠点

WINALITE

ララムーンシリーズ 外箱デザイン

WINALITE

ララムーンシリーズ パッケージデザイン

WINALITE

ララムーンシリーズ商品の魅力

1. 高機能トルマリン＆ナノセラミック配合センターテープ使用（自社特許技術）
2. マイナスイオンで抗菌・消臭 ＆ 遠赤外線で暖か
3. 各素材のもつ機能を最大限に高める多層構造
4. 安全・高機能な超吸収シートで、しっかりガード・清潔に
5. ムレに安心な全面通気性で、いつもサラサラ・快適

WINALITE

高機能トルマリン＆ナノセラミック配合センターテープ使用（自社特許技術）

- ２層目（センターテープ）

  PET不織布にトルマリンパウダー＆ナノセラミックパウダーを、特殊コーティングを施し配合。（自社特許技術）

  1層目（表面層）と3層目（超吸収シート）の間に配置することで、装着中の摩擦作用により、抗菌・消臭（マイナスイオン）＆保温効果（遠赤外線）を最大限に活用します。

環境別マイナスイオン濃度（個/㎤）	
森林・滝	10,000～20,000
山・海辺	5,000～10,000
郊外・田舎	1,000～5,000
都市公園	400～600

マイナスイオン濃度検査結果

Requirements					
NO.	Items	Unit	Requirements	Test Results	Pass/Failure (P/F)
1	Concentration of anion	pics/cm³	/	6160	/
The following is blank.					

＞＞検査値：6,160個/㎤

WINALITE

マイナスイオンで抗菌・消臭＆遠赤外線で暖か

抗菌活性値の検査結果（抜粋）

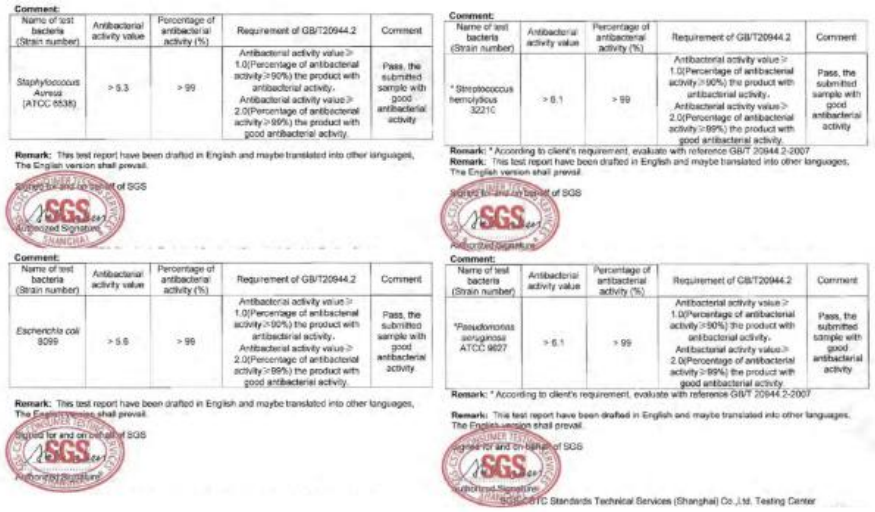

Comment:

Name of test bacteria (Strain number)	Antibacterial activity value	Percentage of antibacterial activity (%)	Requirement of GB/T20944.2	Comment
Staphylococcus Aureus (ATCC 6538)	> 5.3	> 99	Antibacterial activity value ≥ 1.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 90%) the product with antibacterial activity. Antibacterial activity value ≥ 2.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 99%) the product with good antibacterial activity.	Pass, the submitted sample with good antibacterial activity

Remark: This test report have been drafted in English and maybe translated into other languages, The English version shall prevail.

Signed for and on behalf of SGS

Comment:

Name of test bacteria (Strain number)	Antibacterial activity value	Percentage of antibacterial activity (%)	Requirement of GB/T20944.2	Comment
Escherichia coli 8099	> 5.6	> 99	Antibacterial activity value ≥ 1.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 90%) the product with antibacterial activity. Antibacterial activity value ≥ 2.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 99%) the product with good antibacterial activity.	Pass, the submitted sample with good antibacterial activity

Remark: This test report have been drafted in English and maybe translated into other languages, The English version shall prevail.

Signed for and on behalf of SGS

Comment:

Name of test bacteria (Strain number)	Antibacterial activity value	Percentage of antibacterial activity (%)	Requirement of GB/T20944.2	Comment
* Streptococcus hemolytious 32210	> 6.1	> 99	Antibacterial activity value ≥ 1.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 90%) the product with antibacterial activity. Antibacterial activity value ≥ 2.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 99%) the product with good antibacterial activity.	Pass, the submitted sample with good antibacterial activity

Remark: * According to client's requirement, evaluate with reference GB/T 20944.2-2007

Remark: This test report have been drafted in English and maybe translated into other languages, The English version shall prevail.

Signed for and on behalf of SGS

Comment:

Name of test bacteria (Strain number)	Antibacterial activity value	Percentage of antibacterial activity (%)	Requirement of GB/T20944.2	Comment
*Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	> 6.1	> 99	Antibacterial activity value ≥ 1.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 90%) the product with antibacterial activity. Antibacterial activity value ≥ 2.0(Percentage of antibacterial activity ≥ 99%) the product with good antibacterial activity.	Pass, the submitted sample with good antibacterial activity

Remark: * According to client's requirement, evaluate with reference GB/T 20944.2-2007

Remark: This test report have been drafted in English and maybe translated into other languages, The English version shall prevail.

Signed for and on behalf of SGS

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd. Testing Center

細菌の種類	抗菌活性値
大腸菌	5.6
黄色ブドウ球菌	5.3
緑膿菌	6.1
溶血性連鎖球菌	6.1

抗菌活性値：Antibacterial Activity Value
抗菌性試験方法で定められている試験方法で、抗菌効果の程度を判定する指標の値。
抗菌活性値2.0 以上(99%以上の死滅率)で抗菌効果があると規定されている。

遠赤外線検査結果（抜粋）

Series No:	Testing item (Unit)	Requirement for the Standard	Testing Result for the Sample	Assessment to the Sample	Remarks
1	Normal Total Emissivity	≥0.80	0.86	passed	
		Blank below			

標準総放射率：0.86

＞＞セラミックスと同等の高放射率

※セラミックスの放射率：0.8～0.9

WINALITE

ララムーン3種類セット（19パック）

・レギュラーサイズ 10パック（1パック8枚入）
・パンティーライナー 5パック（1パック24枚入）
・ロングサイズ 4パック（1パック8枚入）

WINALITE

各素材のもつ機能を最大限に高める多層構造

- １層目（表面層）

  通気性・柔軟性・軽量性に優れたポリプロピレン不織布に、独自の特殊加工（Drilling構造）を施し、表面を通過した水分が「逆戻りしにくい構造」になっており、究極のサラサラ感を実現しています。

※Drilling構造とは表面がろうと型になっていて、吸収した水分を逃さない構造のこと。

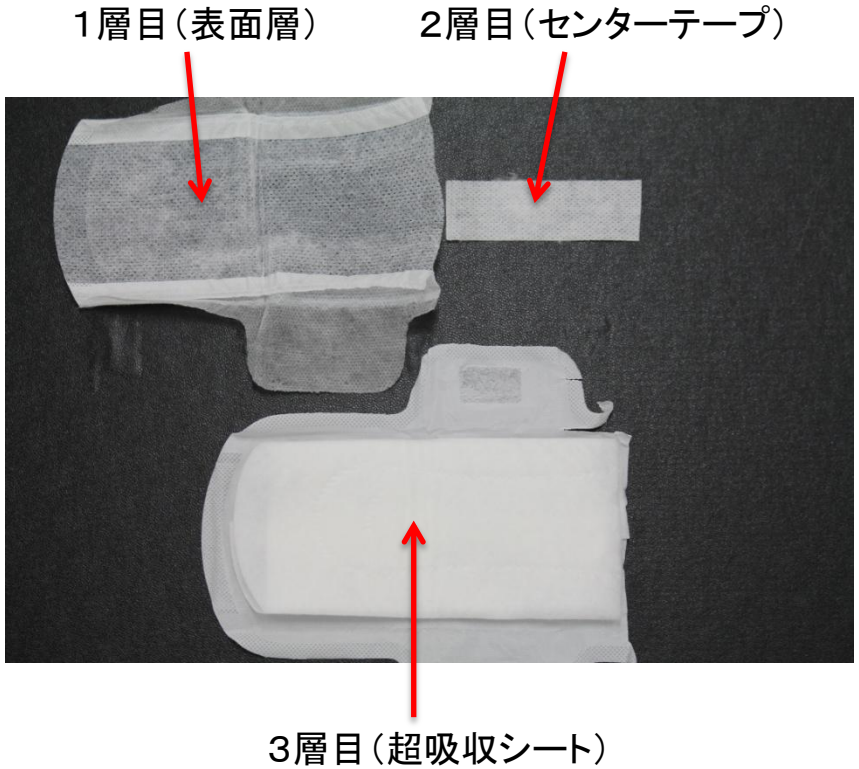

Drilling 構造・ろうと構造

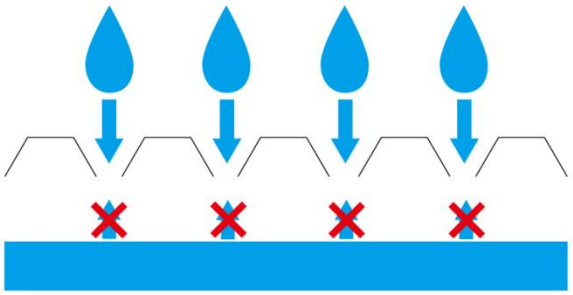

なぜ天然綿を使用しないの？

天然綿はどうしてもその特徴から、吸収した水分が表面にも浮き出てしまいます。（手を拭いたハンカチの表面が濡れたままになる状態）
弊社は通常のものと違い、特殊加工したポリプロピレン不織布を採用しております。これにより、究極のサラサラ感を実現しています。

WINALITE

安全・高機能な超吸収シートで、しっかりガード・清潔に

- ３層目、５層目（超吸収シート）

  ポリオレフィン系不織布と綿状パルプから成る超吸収シートで、４層目の高分子吸収材をくるりと包み込んでいます。

  表面層を通過した水分は、ポリオレフィン系不織布で広がり、素早く綿状パルプで吸収されると同時に高分子吸収材へ導かれます。

３層目、５層目（超吸収シート）

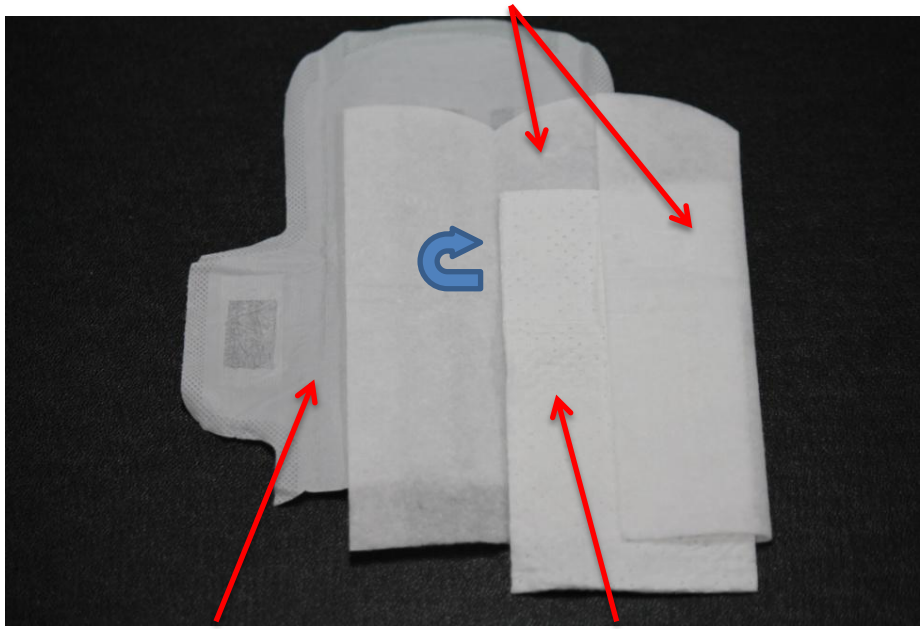

６層目（防水層）　　４層目（高分子吸収材）

WINALITE

安全・高機能な超吸収シートで、しっかりガード・清潔に

- ４層目（高分子吸収材）

自重の約30倍以上の水分を吸収することができ、ゲル状に固まります。

さらに、吸収後の圧力にも耐え、「水分が逆戻りしない」ため不快感がありません。

吸収性のテスト

①水と注入器を用意

②水50cc を注入器に準備

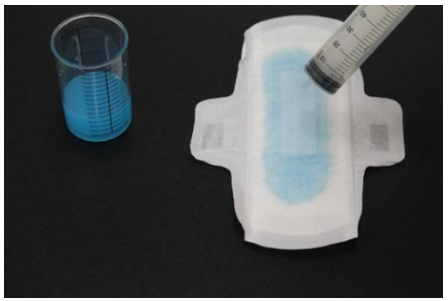

③水50cc を注入

④20秒後、ティッシュで押さえる

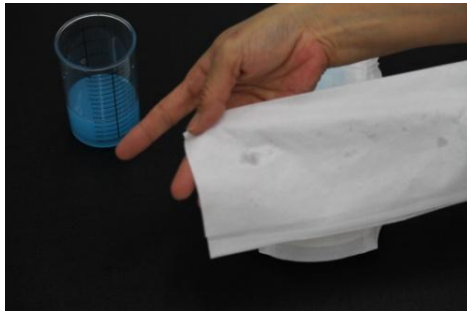

⑤水分をほぼ吸収している

⑥40秒後、水分の逆戻りなし

WINALITE

ムレに安心な全面通気性で、いつもサラサラ・快適

- ６層目（防水層）

  水分を通さないポリエチレンフィルムに高い通気性（全面通気性）を施しております。

- 外装（高価&安心のアルミ箔）

  遮断性・遮光性に優れた厚手のアルミ箔を使用。外部からの酸素や湿気、また光による商品劣化を防ぎます。

  さらに消費期限も記載し、常にフレッシュな商品をお届けできるよう、徹底した品質管理を心掛けております。一般のメーカーより、高価で安心・安全なパッケージを使用しています。

商品全体の通気性テスト（装着時を想定）

①お湯の入ったコップと商品を用意

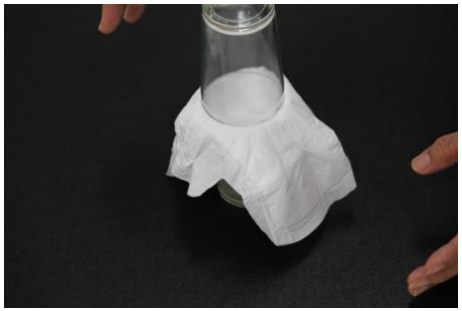

②商品全体をコップに載せて挟む

③1分後、コップに曇り発生
⇒高い通気性

WINALITE

ララムーンパンティーライナーセット（16パック）・1パック24枚入

WINALITE

ユニークなパンティーライナーで、毎日快適

～「ララムーン」にできること、拡大中！！～

- 1層目（表面層）には、セルロースファイバーを採用。綿を原料とした天然素材で、特徴として、ソフトな感触、吸湿性あり、静電気が起きにくい、などがあげられます。

  綿と比較して、吸湿性と通気性がより優れており、その吸湿度は13%～15%と、綿より6%～7%ほど高く、毎日サラサラ、快適にご使用いただけます。

- 2層目には、トルマリンパウダー＆ナノセラミックパウダー配合センターテープを配置。

  1層目（表面層）と3層目（超吸収シート）の間に配置することで、装着中の摩擦作用により、抗菌・消臭・保温効果を最大限に活用します。

- 3層目（超吸収シート）

  ポリオレフィン系不織布と綿状パルプから形成されたシートで、表面層を通過した水分は、ポリオレフィン系不織布で広がり、素早く綿状パルプで吸収されます。

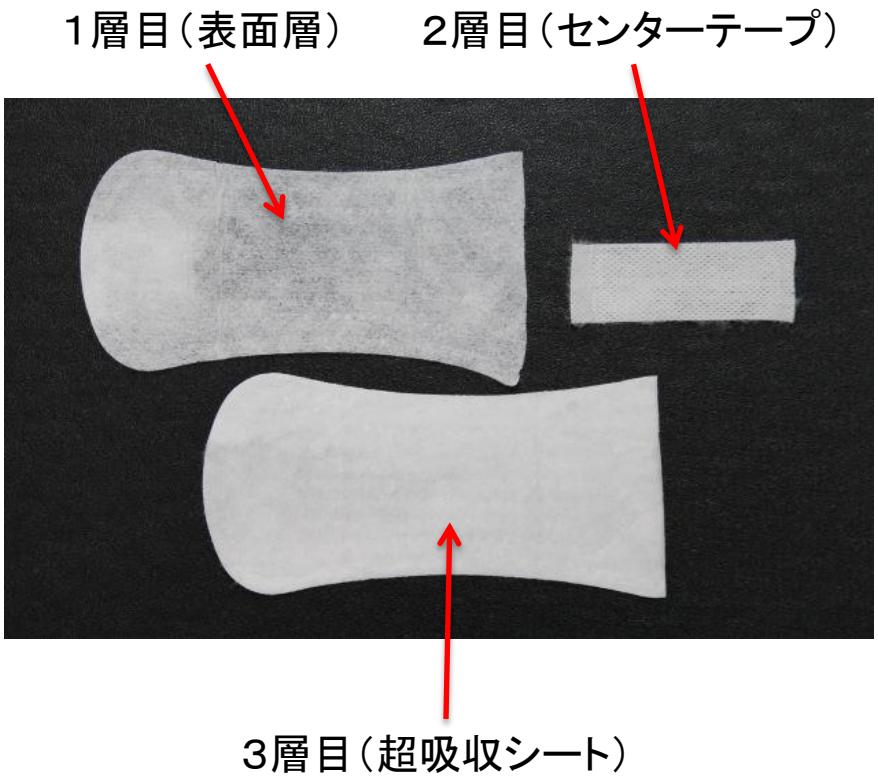

WINALITE

ご愛用者様からのお声

- 生理とは関係のない年齢になりましたが、パンティーライナーを常に使用しています。昔から冷え性で困っていたところ、知人からララムーンを紹介され、この商品を使用してからは、身体の冷えがなくなりました。たまにパンティーライナーを切らしてしまい市販品を代用すると、すぐに身体の冷えが逆戻りします。本当にララムーンは冷え性の私には手放せない大切なものです。一生のおつきあいと思っています。

- 帯状疱疹になった時にパンティーライナーを貼りました。治りが早く医者も驚いていました。これからもよろしくお願いします。

- 臭いに敏感なので、生理の時は特に周囲に気を使っていましたが、ララムーンに出会ってからは全く気にならなくなりました。いつもサラっとしているので、ムレなどの不快感もありません。

- 何年もララムーンにお世話になっております。生理痛や頭痛に悩まされていたのですが、使いはじめてから嘘のように軽減されました。今では娘も使用しています。

※個人の感想です。

LINE@からのお問合せもマンツーマンにて対応いたします！

LINE ID：@winalite.jp

友だち追加

株式会社ウィナライトジャパン
TEL：03-3980-9666